オキシメトリーアクセサリー/無線ブロードバンドルーター導入 簡易取扱説明書

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

1 各部品の名称と設置イメージ

※下記の内容物が全てそろっていることを確認します。

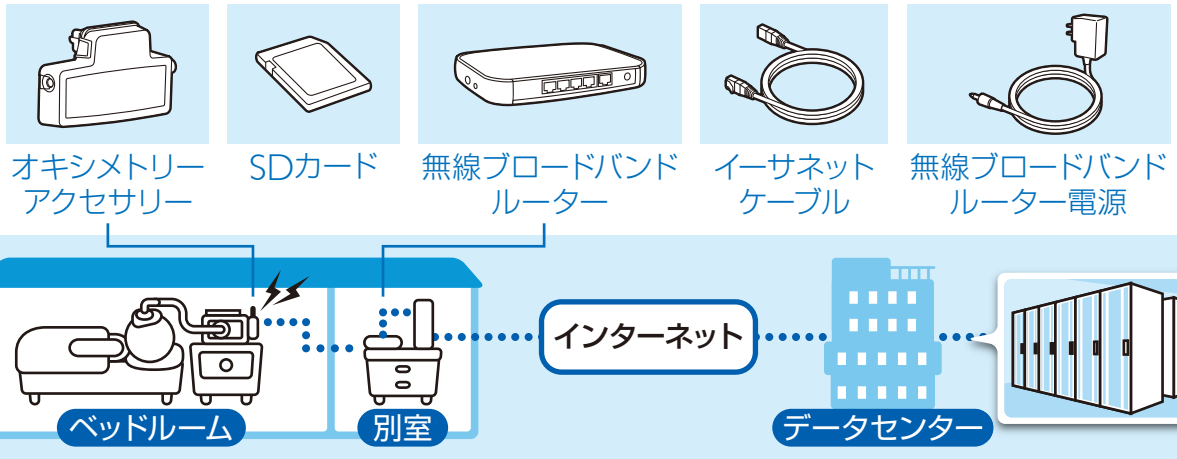

2 オキシメトリーアクセサリーの取り付け

1 CPAP装置の電源を抜きます。
CPAP装置背面のSDカードカバーを取り外します。
※SDカードは取り外さないでください。

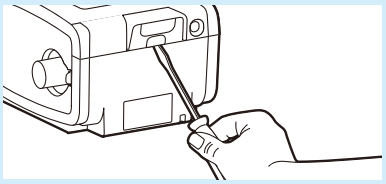

2 オキシメトリーアクセサリーの
赤い端子カバーを取り外します。

※金属部に触れないようご注意ください。

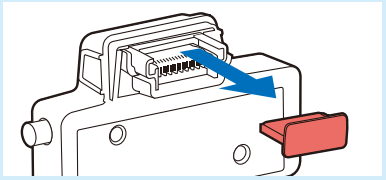

3 オキシメトリーアクセサリーを機器背面の
差込口にしっかりと差し込んでください。

※取り外したCPAP装置背面のSDカードカバー、端子カバーは機器返却時まで保管してください。

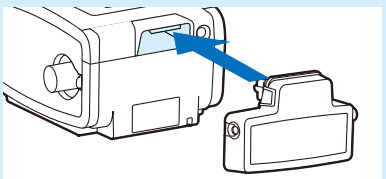

3 無線ブロードバンドルーターの設置～利用開始

1

ご自宅のネットワーク設備と無線ブロードバンドルーターを接続します。
ご自宅のインターネット接続設備と無線ブロードバンドルーターを接続する際は、イーサネットケーブルを使用します。

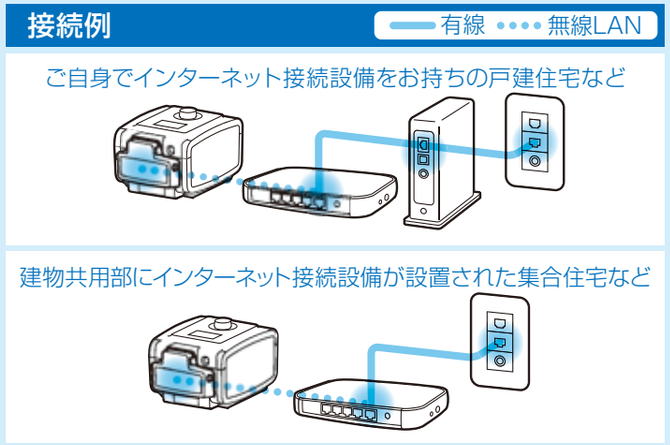

2

アクセスポイントの電源コードを接続し、電源を入れます。約30秒後、ランプが右図のように点灯します。

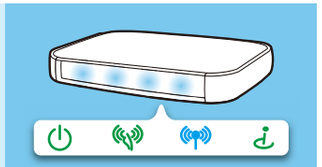

3

CPAP装置の電源を入れて、オキシメトリーアクセサリーの左側面にあるコールボタンを2秒間押し続けます。

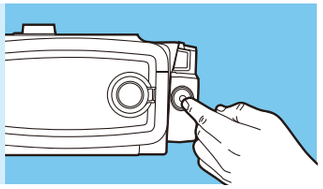

4

接続が成功していればCPAP装置の表示画面に右図のマークが表示されます。

治療が終了したら

CPAP装置の停止ボタンを押してから1時間後に治療データがEncoreAnywhereへ転送されます。

※治療終了後すぐにCPAP装置の電源コードを外すと通信が行われません。すぐに通信を行う場合は治療後に 3 -③,④ の手順を行います。チェックマークが表示されれば電源コードを外しても問題ありません。

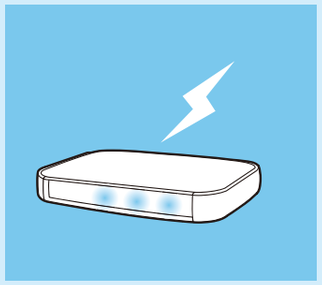

4 よくある質問

Q1. 使用しない時は、無線ブロードバンドルーターの電源を抜いてもいいですか？

通常は治療終了後も、電源は抜かないでください。
※停電・移設等の場合に限り、電源を抜いてください。再度電源を入れた後は、左ページ 3 の接続チェック項目を参照し、正しく接続できることをご確認ください。

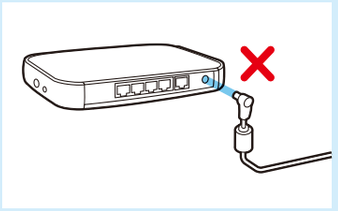

Q2. 市販の無線LANルーターとオキシメトリーアクセサリーを直接通信することは可能ですか？

お手元のオキシメトリーアクセサリーは、無線ブロードバンドルーターだけに接続を行うように設定されています。市販品と直接通信することはできませんので、ご自宅に無線LANルーターをお持ちの方も無線ブロードバンドルーターを別途ご使用ください。

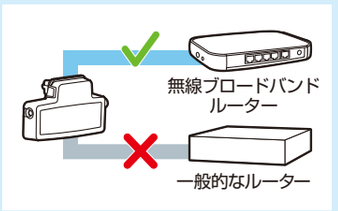

Q3. 接続チェックでエラーアイコンが表示されるのですが…？

接続チェック時に以下のようなアイコンが表示されることがあります。
その他のアイコンにつきましては取扱説明書をご覧になるか、弊社担当営業までお問い合わせください。

表示	状態	対策
✕ ----	無線ネットワーク信号なし 接続不可	CPAPと無線ブロードバンドルーターを近づけてください。
1	ネットワーク接続なし	取付を確認してください。CPAP装置を無線ブロードバンドルーターに近づけてください。
1 ?	システムへの 接続が許可されていない	弊社の登録作業が済んでいません。 2~3日経っても表示が消えない場合は、弊社担当営業までご連絡ください。
2 ?		

製造販売業者
フィリップス・レスピロニクス合同会社
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1
本社　〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
マーケティング部　03-3740-3245
www.philips.co.jp/respironics/

販売名：レムスターAuto PRIシステム
医療機器承認番号：22200BZX00874000
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

販売名：REMstar Pro System One 60シリーズ
医療機器承認番号：22500BZX00477000
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

販売名：REMstar Auto System One 60シリーズ
医療機器承認番号：22500BZX00268000
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

販売名：BiPAP Auto System One 60シリーズ
医療機器承認番号：22500BZX00448000
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

フィリップス・レスピロニクス合同会社
お客さまコールセンター
0120-48-4159（よるはよいこきゅう）
受付時間：平日9:00~17:00 土10:00~17:00 ※日・祝日休業

© 2014 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問合せください。記載されている製品名などの固有名詞は、
Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1116217 140401 R1-W Printed in Japan